



Dichtheitsprüfgeräte
 CETA 800 (C 800)
 CETATEST 510 (CT 510)
 CETATEST 710 (CT 710)
 CETATEST 810 (CT 810)

Massenflussprüfgerät
 CETATEST 610

Durchflussprüfgerät
 CETA 900 (C 900)

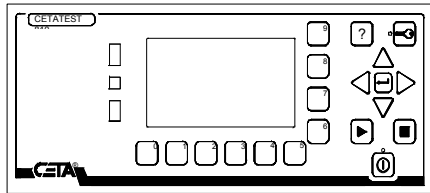

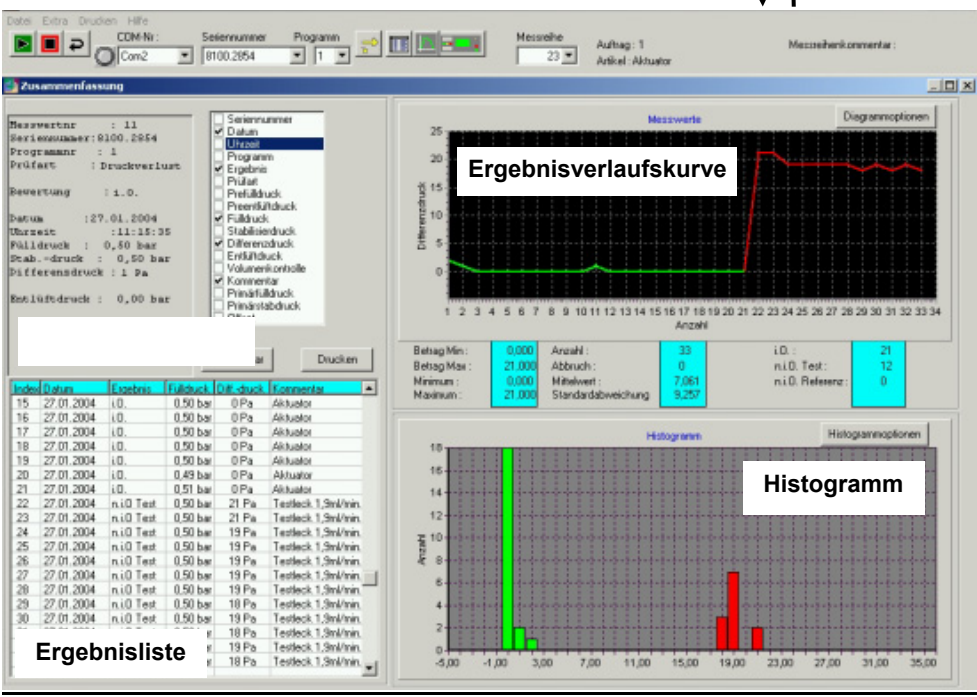

	Beschreibung
Einsatzbereich	Die Applikationssoftware CETA Soft ist ein speziell für die Kommunikation mit den CETA-Prüfgeräten entwickeltes Programm. Es ermöglicht die Steuerung der Prüfgeräte, die Übertragung von Parametern, die Messwernerfassung und Messwertauswertung (inkl. automatisierter Prüfteilbewertung).
Funktionsübersicht	<ul style="list-style-type: none"> • Aufnahme von Messreihen • Messreihenverwaltung • Parameterraustausch • Offlinebetrieb
Messergebnisse und Messreihen	<ul style="list-style-type: none"> • Anlegen und Speichern von Messreihen • Fortführung einer aufgenommenen Messreihe • Im- und Export von Messreihen [in Planung] • Messreihenliste (Verwaltung von Messreihen) • Eingabe von Zusatzdaten zu einer Messreihe (Artikelnummer, Auftragsnummer, Kommentar) • Messwertspeicherung mit Datum und Uhrzeit
Datenexport	<ul style="list-style-type: none"> • Datelexport im ASCII-Format (.txt) • Ausdruck von Messreihen
Statistische Auswertungen	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl aller Messwerte • Anzahl der Prüfergebnisse (i.O., n.i.O., Abbrüche) • Maximal- und Minimalwert innerhalb der Messreihe • Mittelwert und Standardabweichung

Graphische Darstellung	<ul style="list-style-type: none"> • Online-Darstellung der Messwerte* • Messwertdiagramm* (zeitlicher Verlauf der Messwerte, farbige Darstellung der Messwertbewertungen) • Histogramm (farbige Darstellung der Messwertbewertungen, konfigurierbare Darstellung der Messbereiche, automatische Datenaktualisierung bei Messwertempfang) <p>* Nicht bei allen Gerätevarianten möglich</p>																																					
Parameternaustausch mit CETA-Prüfgeräten	<ul style="list-style-type: none"> • Editierung und Speicherung der Prüfprogramme • Einstellung der Prüfmart und Parametereingabe in einer für die Prüfmart spezifischen Eingabemaske <p>Protokoll der Parameter (Seriennummer, Programmnummer, Uhrzeit, Einstellungen [Füllen, Stabilisieren, Messen, Entlüften], Bewertung der Prüfergebnisse)</p>																																					
Betrieb mehrerer CETA Prüfgeräte	<ul style="list-style-type: none"> • Gleichzeitige Steuerung von bis zu 4 CETA-Prüfgeräten über einen PC • Speicherung der Messdaten aller angeschlossenen CETA-Prüfgeräte 																																					
Offlinebetrieb	<ul style="list-style-type: none"> • Eingabe von Parametern ohne angeschlossenes CETA-Prüfgerät [in Planung] • Auswertung der Messwerte ohne angeschlossenes CETA-Prüfgerät 																																					
Sprachversionen	<ul style="list-style-type: none"> • Deutsch, Englisch (im Programm wählbar) 																																					
Verfügbare Versionen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="5" style="text-align: center;">Firmware</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">2.xx</th> <th style="text-align: center;">3.xx</th> <th style="text-align: center;">4.xx</th> <th style="text-align: center;">5.xx</th> <th style="text-align: center;">6.xx</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); text-align: center;">Prüfgerät</td> <td>C 800 (*)</td> <td>CETA Soft 2.xx</td> <td>CETA Soft 3.xx / 4.xx</td> <td>CETA Soft 3.xx / 4.xx</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C 900</td> <td>CETA Soft 2.xx</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CT 510 CT 810</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CETA Soft 3.xx / 4.xx</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CT 710</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CETA Soft > 4.11</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(*) CETA 800 Standardausführung</p>			Firmware					2.xx	3.xx	4.xx	5.xx	6.xx	Prüfgerät	C 800 (*)	CETA Soft 2.xx	CETA Soft 3.xx / 4.xx	CETA Soft 3.xx / 4.xx			C 900	CETA Soft 2.xx					CT 510 CT 810				CETA Soft 3.xx / 4.xx		CT 710					CETA Soft > 4.11
				Firmware																																		
		2.xx	3.xx	4.xx	5.xx	6.xx																																
Prüfgerät	C 800 (*)	CETA Soft 2.xx	CETA Soft 3.xx / 4.xx	CETA Soft 3.xx / 4.xx																																		
	C 900	CETA Soft 2.xx																																				
	CT 510 CT 810				CETA Soft 3.xx / 4.xx																																	
	CT 710					CETA Soft > 4.11																																
Systemvoraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium PC 133 MHz • 32 MB Hauptspeicher • 20 MB Speicherplatzbedarf auf der Festplatte • Bildschirmauflösung 1024 x 768 (empfohlen) • Lauffähig unter folgenden Betriebssystemen: CETA Soft 2.xx: Win 3.11, Win 95, Win 2000, Win XP CETA Soft 3.xx: Win 95, Win 98, Win NT 4.0, Win 2000, Win XP CETA Soft 4.xx: Win 98, Win NT 4.0, Win 2000, Win XP 																																					
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • Programm-CD, Handbuch • 9 poliges 1:1-Kabel zur Verbindung der seriellen RS 232 PC-Schnittstelle mit dem CETA-Prüfgerät 																																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> CETA Testsysteme GmbH Marie-Curie-Straße 35-37 40721 Hilden DEUTSCHLAND </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Tel.: +49 (0) 2103 / 2471 - 75 Fax: +49 (0) 2103 / 2471 - 76 E-Mail: sales@cetatest.com Internet: www.cetatest.com </td> </tr> </table>		CETA Testsysteme GmbH Marie-Curie-Straße 35-37 40721 Hilden DEUTSCHLAND	Tel.: +49 (0) 2103 / 2471 - 75 Fax: +49 (0) 2103 / 2471 - 76 E-Mail: sales@cetatest.com Internet: www.cetatest.com																																			
CETA Testsysteme GmbH Marie-Curie-Straße 35-37 40721 Hilden DEUTSCHLAND	Tel.: +49 (0) 2103 / 2471 - 75 Fax: +49 (0) 2103 / 2471 - 76 E-Mail: sales@cetatest.com Internet: www.cetatest.com																																					